

Digi Test pH

Brugervejledning

DK

Digi Test pH

A – Batterirum (2x LR44)

B – LCD-display (pH)

C – Tænd/sluk


D – Kalibrering

E – Nedsænkningslinje

F – Elektroder

H – pH-bufferpulver, 1-punktskalibrering

I – pH-bufferpulver, 2-punktskalibrering

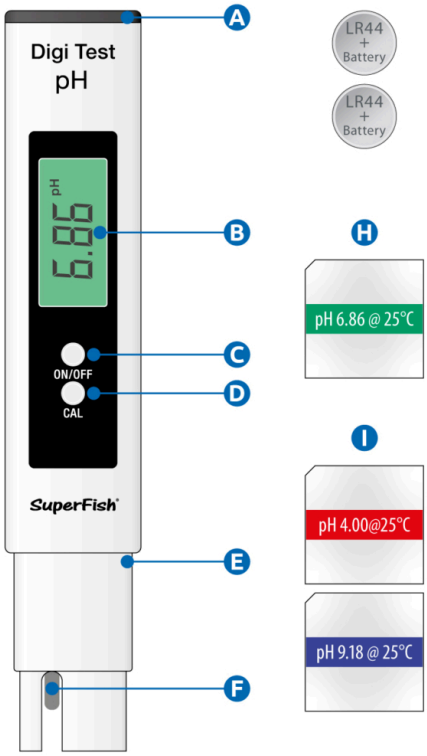

Præcis pH-måler til vand i akvarier og havedamme

- Måler pH fra 0-14 med en præcision på op til 0,02 enheder.
- Instrumentet har en automatisk kalibreringsfunktion til både 1-punktskalibrering (6.86) og 2-punktskalibrering (4.00 – 9.18).
- Kalibreringspulver medfølger.
- Automatisk slukning efter 5 min.


Brug

- Fjern beskyttelseshætten før brug.
- Tryk på tænd/sluk-knappen.
- Sænk pH-måleren ned i vandet til nedsænkningslinjen. Måleren er IKKE vandtæt. Sænk aldrig måleren længere ned i vandet end til nedsænkningslinjen.
- Vent cirka 30 sekunder, indtil målingen er stabil.
- Aflæs vandets pH-værdi.
- Skyl elektroden med destilleret vand, tør den med en serviet, og sæt hætten på igen.
- Undgå varme og direkte sollys.

1-punktskalibrering 6.86

Kalibreringsnøjagtigheden er ± 0.1 pH


1. Opløs pH 6.86-bufferpulveret i en kop med 250 ml destilleret vand ved 25 °C.
2. Sænk pH-måleren ned i vandet med pH 6.86-opløsningen, og vent cirka 30 sek.
3. Tryk på CAL-knappen, og hold den nede i 5 sek.
   6.86 begynder at blinke på displayet.
4. Når blinkene stopper, er pH-måleren kalibreret.



Skyl elektroden med destilleret vand, tør den med en serviet, og sæt hætten på igen.

2-punktskalibrering 4.00 og 9.18

Kalibreringsnøjagtigheden er ± 0.02 pH

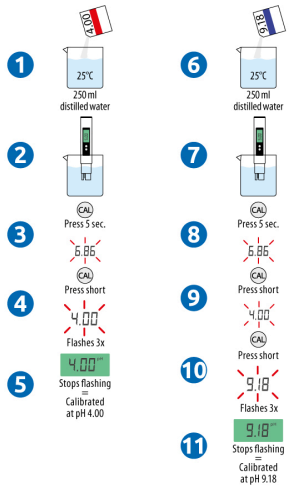

1. Opløs pH 4.00-bufferpulveret i en kop med 250 ml destilleret vand ved 25 °C.
2. Sænk pH-måleren ned i vandet med pH 4.00-opløsningen, og vent cirka 30 sek.
3. Tryk på CAL-knappen, og hold den nede i 5 sek.
   6.86 begynder at blinke på displayet.
4. Tryk straks kort på CAL-knappen.
   4.00 blinker på displayet.
5. Vent, indtil blinkene stopper.

   Skyl elektroden med destilleret vand
6. Opløs pH 9.18-pulveret i en anden kop.
7. Sænk nu pH-måleren ned i vandet med pH 9.18-opløsningen, og vent cirka 30 sek.
8. Tryk på CAL-knappen, og hold den nede i 5 sekunder.
   6.86 begynder at blinke på displayet.
9. Tryk straks kort på CAL-knappen.
   4.00 blinker på displayet.
10. Tryk straks på CAL-knappen igen.
    9.18 blinker nu på displayet.
11. Når blinkene stopper, er pH-måleren kalibreret.

Skyl elektroden med destilleret vand, tør den med en serviet, og sæt hætten på igen.

Vedligeholdelse

- Hold elektroden ren og tør.
- Sæt altid hætten på måleren.

Garanti

1 års producentgaranti. Skader som følge af forkert brug (batterilækage, vandskader) er ikke dækket. Gem altid købsbeviset; uden købsbevis bortfalder garantien!

De medfølgende batterier har en levetid på 1 år. Hvis de er tomme på købstidspunktet, skal du selv udskifte dem.

Information om genbrug



Dette symbol angiver, at dette produkt (hvis det kasseres) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres på et officielt indsamlingssted (f.eks. genbrugsstation). Det kan også returneres til forhandleren ved køb af et lignende nyt produkt. Følg de gældende regler i dit land for separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Separat indsamling og genanvendelse er bedre for miljøet, folkesundheden og reducerer affald.