

Digi Test pH

Manuel d’utilisation

FR

Digi Test pH

A – Compartiment à piles (2x LR44)

B – Écran LCD (pH)

C – Marche / Arrêt


D – Étalonnage

E – Ligne d'immersion

F – Électrodes

H – Poudre tampon pH, étalonnage en 1 point

I – Poudres tampons pH, étalonnage en 2 points

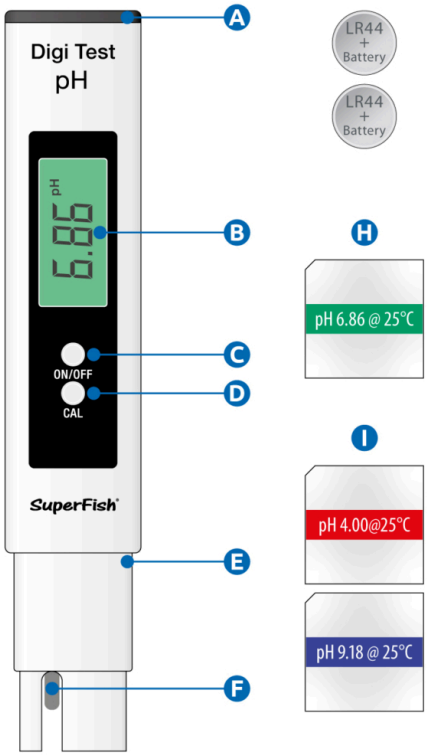

pH-mètre précis pour l'eau des aquariums et des bassins


- Mesure le pH de 0 à 14 avec une précision pouvant atteindre 0,02 unité.
- L'appareil dispose d'une fonction d'étalonnage automatique en 1 point (6.86) ou en 2 points (4.00 – 9.18).
- Les poudres d'étalonnage sont incluses.
- Arrêt automatique après 5 min.

Utilisation

- Retirez le capuchon de protection avant utilisation.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
- Plongez le pH-mètre dans l'eau jusqu'à la ligne d'immersion. Le pH-mètre n'est PAS étanche ; ne le plongez jamais au-delà de la ligne d'immersion.
- Attendez environ 30 secondes, jusqu'à ce que la mesure se stabilise.
- Lisez la valeur du pH de l'eau.
- Rincez l'électrode à l'eau distillée, séchez-la avec un mouchoir en papier et remettez le capuchon.
- Évitez la chaleur et l'exposition directe au soleil.

Étalonnage en 1 point : 6.86

La précision de l'étalonnage est de ± 0,1 pH




1. Dissolvez la poudre tampon pH 6.86 dans un récipient contenant 250 ml d'eau distillée à 25°C.
2. Plongez le pH-mètre dans l'eau contenant la solution pH 6.86 et attendez environ 30 secondes.
3. Maintenez le bouton CAL enfoncé pendant 5 secondes.
   6.86 se met à clignoter à l'écran.
4. Lorsque le clignotement cesse, le pH-mètre est étalonné.

Rincez l'électrode à l'eau distillée, séchez-la avec un mouchoir en papier et remettez le capuchon.

Étalonnage en 2 points : 4.00 et 9.18

La précision de l'étalonnage est de ± 0,02 pH

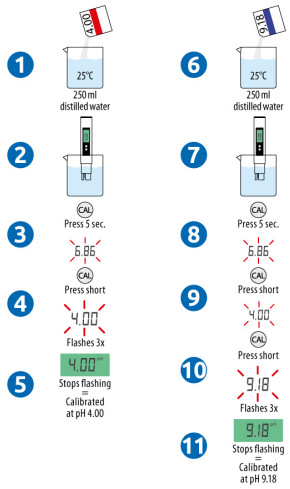

1. Dissolvez la poudre tampon pH 4.00 dans un récipient contenant 250 ml d'eau distillée à 25°C.
2. Plongez le pH-mètre dans l'eau contenant la solution pH 4.00 et attendez environ 30 secondes.
3. Maintenez le bouton CAL enfoncé pendant 5 secondes.
   6.86 se met à clignoter à l'écran.
4. Appuyez immédiatement brièvement sur le bouton CAL.
   4.00 clignote à l'écran.
5. Attendez que le clignotement cesse.

   Rincez l'électrode à l'eau distillée

6. Dissolvez la poudre pH 9.18 dans un autre récipient.
7. Plongez ensuite le pH-mètre dans l'eau contenant la solution pH 9.18 et attendez environ 30 secondes.
8. Maintenez le bouton CAL enfoncé pendant 5 secondes.
   6.86 se met à clignoter à l'écran.
9. Appuyez immédiatement brièvement sur le bouton CAL.
   4.00 clignote à l'écran.
10. Appuyez immédiatement une nouvelle fois sur le bouton CAL.
    9.18 clignote alors à l'écran.
11. Lorsque le clignotement cesse, le pH-mètre est étalonné.

Rincez l'électrode à l'eau distillée, séchez-la avec un mouchoir en papier et remettez le capuchon.

Entretien

- Veillez à ce que l'électrode reste propre et sèche.
- Refermez toujours le pH-mètre avec son capuchon.

Garantie

Garantie fabricant de 1 an. Les dommages dus à une utilisation incorrecte (fuite des piles, dégâts des eaux) ne sont pas couverts. Conservez toujours la preuve d'achat ; sans celle-ci, la garantie est annulée !

Les piles fournies ont une durée de vie d'un an. Si elles sont déchargées au moment de l'achat, vous devez les remplacer vous-même.

Informations sur le recyclage



Ce symbole indique que ce produit (s'il est jeté) ne peut pas être éliminé avec les ordures ménagères normales. Au lieu de cela, il doit être déposé dans un centre de collecte officiel, ou peut être retourné au revendeur lors de l'achat d'un nouveau produit similaire. Suivez les règles applicables dans votre pays pour la collecte séparée des produits électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés sont meilleurs pour l'environnement, la santé publique et réduisent les déchets.